



伊维菌素免疫胶体金快速检测卡

伊维菌素免疫胶体金参数

产品简介

本产品用于快速检测原奶(生鲜乳)中的伊维菌素残留,整个检测过程只需要 15 分钟左右, 灵敏度为 150 μ g/kg (ppb), 阿维菌素灵敏度为 50ppb,适用于各类企业及检测机构。

产品组成

伊维菌素免疫胶体金快速检测试剂板

说明书 (1 份/盒)

需使用但未提供的试剂、器具

加热器、微量移液器

操作步骤

1. 撕开伊维菌素免疫胶体金快速检测试剂板包装, 取出金标微孔。


(试验环境的温度必须 20 度以上.冷冻过的原奶,明显出现颗粒的,容易导致跑板不完全, 此时必须使用加热器加热或者离心取中间层样本进行检测。)

2. 用移液枪取 150 UL(或用滴管取 5 滴) 生乳于金标微孔中, 2 分钟后用滴管吹

打生乳(吹打不低于 10 次), 将混匀的生乳用滴管吸取滴加到试剂板的加样孔中。

3. 8-10 分钟后判读结果。

结果判断

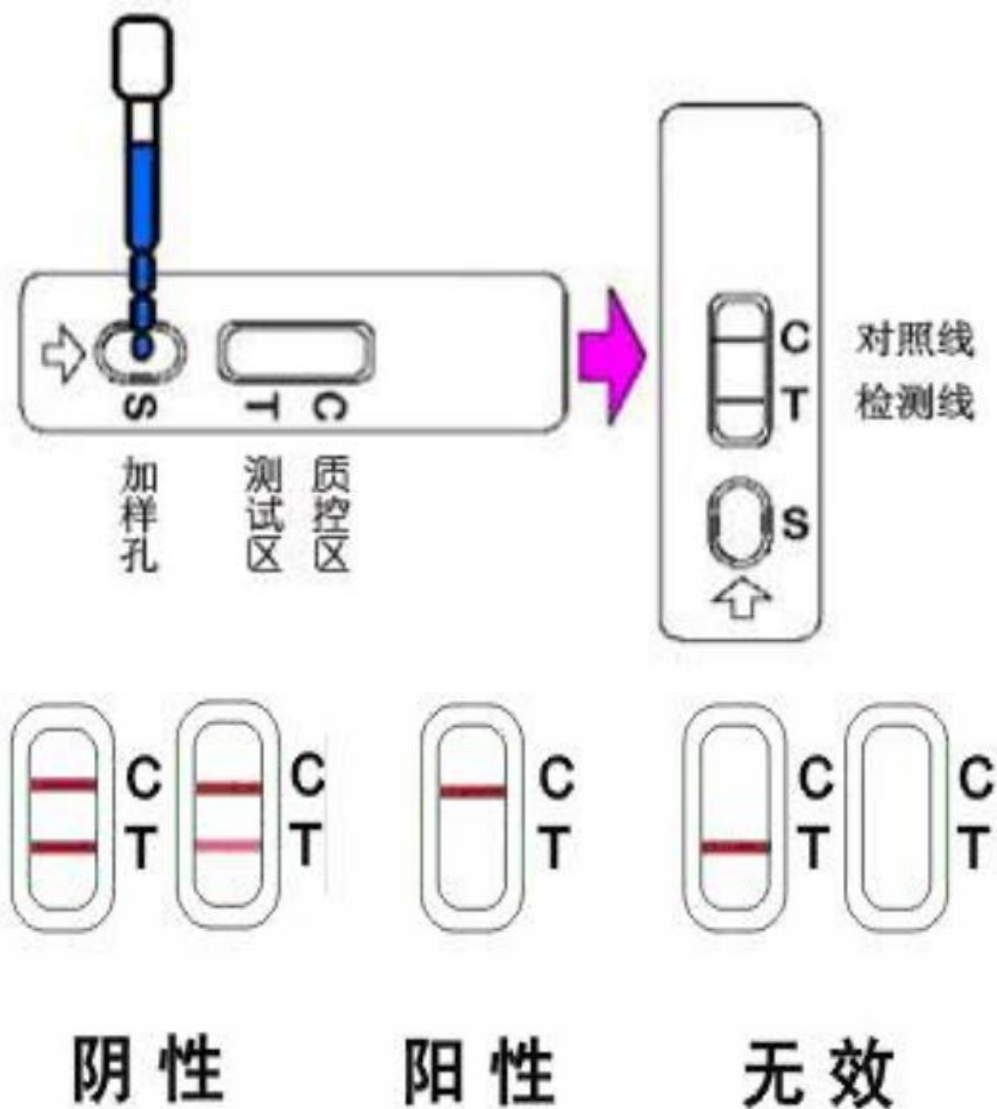

阴性(-)： T 线（检测线，靠近加样孔一端）显色比 C 线（对照线）深或一样深，表明样品中伊维菌素浓度低于检测限或无伊维菌素残留。

阳性(+)： T 线显色明显比 C 线浅，或 T 线无显色，表明样品中伊维菌素浓度高于检测限；T 线比 C 线越浅，表明样品中伊维菌素浓度越高。

无效： 未出现 C 线，可能操作不当或试剂板已失效。应再次阅读说明书，并用

新的试剂板重新测试。

注意事项

1. 试剂条一次性使用；
2. 不要使用过期试剂条，废弃物应妥善处理；
3. 请勿触摸试剂条中央的白色膜面；
4. 切勿重复使用配备的滴管，以免交叉污染；
5. 切勿食用配备的试剂；
6. 若需直接检测标准品，我方可提供配置液；
7. 试验遇到的任何问题，请与供应商联系。

特异性

本产品与四环素、链霉素、磺胺类药物无交叉反应。

贮存条件

4℃~30℃避光保存，切勿冷冻

有效期 12 个月。

生产日期 详见包装袋。



www.mlbio.cn

[微信公众号](#)

[手机官网](#)

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com